

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tamowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tamowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet 15 – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT system).

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia do postępowania w Pakiecie 15 taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o szer. 1,1 cm, w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania. W zestawie 2 szt. narzędzi wielokrotnego użytku, o dwupłaszczyznowym wygięciu igieł o średnicy ok. 3,5-4 mm, implantacja z dostępu przez otwory zasłonione.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

dotyczy PAKIETU NR 5 poz. 74 i 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu równoważnego o pojemności 6 ml w poz. 74 oraz 11ml w poz. 75 sterylizowanego radiacyjnie, spełniającego wymagania techniczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 56 poz. ż wymaga jednorazowych magazynków niewymagających zginania podczas ładowania soczewki, czyli bez klasycznych ruchomych skrzydełek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

PAKIET 7 – PORTY NACZYNIOWE I

Czy Zamawiający zaakceptuje porty o następującej specyfikacji:

- 1) Wszczepialny port hybrydowy (komora – tytan, obudowa – polioksymetylen):
 - a. Cewnik silikonowy: średnica wewnętrzna 1,02 mm (3,06F) – średnica zewnętrzna 2,16 mm (6,48F) lub średnica wewnętrzna 1,20 mm (3,60F) – średnica zewnętrzna 2,40 mm (7,20F) według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego,
 - b. Igła do infuzji ze szlifem Hubera, poliuretanowym drenem (25 cm) i zaciskiem w oddzielnym opakowaniu.
- 2) Wszczepialny port hybrydowy (komora – tytan, obudowa – polioksymetylen) o wysokim przepływie (3,1 l/h = 52 ml/min)
 - a. Wysokość max. 12,2 mm,
 - b. Cewnik silikonowy: średnica wewnętrzna 1,57 mm (4,71F) – średnica zewnętrzna 3,18 mm (9,54F)
 - c. Igła do infuzji ze szlifem Hubera, poliuretanowym drenem (25 cm) i zaciskiem w oddzielnym opakowaniu.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

PAKIET 8 – PORTY NACZYNIOWE II

Czy Zamawiający zaakceptuje sprzęt o następującej specyfikacji:

- 1) Wszczepialny port hybrydowy (komora – tytan, obudowa – polioksymetylen):
 - a. Średnica membrany max 12,1 mm,
 - b. Komora portu o objętości 0,6 ml,
 - c. Cewnik silikonowy o długości 600 mm: średnica wewnętrzna 1,20 mm (3,60F) – średnica zewnętrzna 2,40 mm (7,20F) lub średnica wewnętrzna 1,57 mm (4,71F) – średnica zewnętrzna 3,18 mm (9,54F) według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego,
 - d. Komora kolistą z tradycyjnym ułożeniem kaniuli
- 2) Igły do wlewów typu Hubera z drenem, zaciskiem i systemem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem oraz kontaktem z krwią pacjenta:
 - a. Z ekstraktorem (kolor wskazuje na grubość igły) zamiast motylka umożliwiającym prawidłowe

- usunięcie igły przez jedną osobę,
b. O długości 20 mm i grubościach 19G, 20G, 22G według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

PAKIET 7 i 8 – PORTY NACZYNIOWE I i II (pytania wspólne dla obu pakietów)

Czy Zamawiający wymaga, aby:

- 1) Igła Seldingera do nakłucia posiadała tzw. dumpling (zwierciadełko na bagnecie igły wzmacniające odbicie sygnału USG podczas nakłucia) zwiększający jej widoczność w badaniu USG?
- 2) Zestaw wprowadzający wyposażony był w bańkę Raulersona do nakłucia z zaworem zapobiegającym krwawieniu podczas wsuwania przewodnika?
- 3) Igła do wlewu była igłą bezpieczną w pełni zabezpieczającą personel medyczny przed zakłuciem i kontaktem z krwią pacjenta oraz umożliwiającą obserwację miejsca nakłucia?
- 4) Port posiadał na obudowie znacznik widoczny w każdym badaniu obrazowym informujący o maksymalnym dopuszczalnym przepływie środków kontrastujących oraz o właściwym ułożeniu portu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 7

PAKIET 32 – IGLY HUBERA

Czy Zamawiający zaakceptuje igły Hubera o następującej specyfikacji:

1. Skład wyrobu medycznego i akcesoriów:

Część składowa / surowiec:

- 1.1. Igła / stal nierdzewna
- 1.2. Osłonka igły / polietylen
- 1.3. Podłączenie luer lock żeńskie do drenu / twardej PCV
- 1.4. Zatyczka Luer-lock / twardej PCV
- 1.5. Dren (średnica: zewnętrzna 3 mm, wewnętrzna 1,95 mm) / PCV wolny od ftalanów (DEHP)
- 1.6. Zacisk jednopozycyjny / polioksymetylen
- 1.7. Uchwyt igły / MABS (Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene)
- 1.8. Ekstraktor / MABS (Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene)
- 1.9. Tłoczek / polipropylen
- 1.10. Pianka ochronna / poliolefiny polietylenu

2. Informacje dodatkowe dotyczące części składowych, które mogą mieć kontakt z pacjentem i / lub podawanymi substancjami:

- 2.1. Wolne od ftalanów,
- 2.2. Wolne od lateksu (surowce i opakowanie),
- 2.3. Wolne od produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

3. Wskazania:

Igły PPS Flow+® to bezpieczne igły o szlifie Hubera, są wskazane do iniekcji i wlewów leczniczych, transfuzji krwi przez membranę silikonową za pośrednictwem wszczepialnych portów dostępu. Igły zapobiegają ekspozycji personelu na patogeny przenoszone przez krew spowodowanej przez przypadkowe zakłucia igłą. Usuwanie jedną ręką bezpiecznej igły Hubera automatycznie generuje naciski i iniekcję soli fizjologicznej do cewnika portu wszczepialnego, zmniejszając w ten sposób ryzyko zatorów krwiopochodnych w dystalnym końcu cewnika.

4. Warunki przechowywania: Okres ważności produktu: 5 lat


5. Rozmiary:

- 5.1. Dostępne grubości: 19G, 20G, 22G
- 5.2. Dostępne długości: 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm

6. Kompatybilność wyrobu z rezonansem magnetycznym (MRI) została zwalidowana testami przeprowadzonymi według międzynarodowej normy ASTM (American Society for Testing and Materials) F 2052-06e1 w następujących warunkach:

- 6.1. pole magnetyczne statyczne o sile minimum 3 Tesla,
- 6.2. maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego minimum 720 Gauss/cm,
- 6.3. raportowany maksymalny rezonans magnetyczny, swoiste tempo pochłaniania energii (SAR - Specific absorption rate) rzędu 2,9 W/kg na 15 min.

7. Dopuszczalny okres utrzymywania igły w porcie: dzień nakłucia + 7 dni pod opatrunkiem przeziernym.

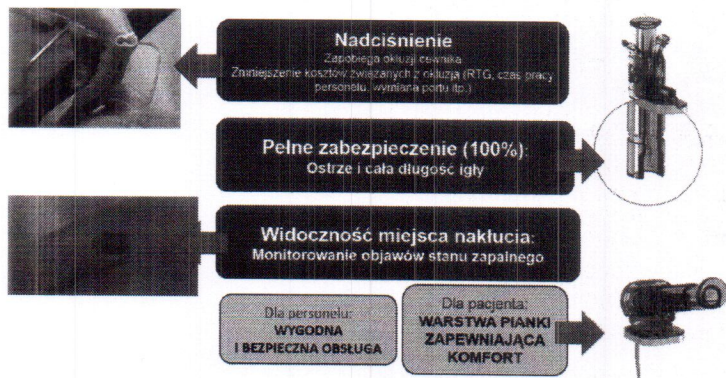

Czy Zamawiający sprecyzuje oddzielnie ilość igieł z portem bocznym i bez portu bocznego w celu właściwego sporządzenia oferty?

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i jednocześnie informuje, że 100% zamówienia na igły dotyczy igieł bez portu bocznego.

Pytanie 8

Dot. pakietu 22

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na tamponadę w opakowaniach zawierających 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem tj. zaoferowanie 20 op. po 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 18

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści strzykawkę do TBC 1 ml z igłą 0,5 x 16

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 3,4,5, 6, dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze zielonym , czarna czytelna skala oraz nazwa producenta oraz logo na korpusie strzykawki a także rozszerzenie skali :

- 2 ml rozszerzona do 3 ml

- 5 ml rozszerzona do 6 ml

- 10 ml rozszerzona do 12 ml

- 20 ml rozszerzona do 24 ml

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 strzykawkę trzyczęściową typu luer 50(60 ml)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 strzykawkę trzyczęściową luer-lock 10(12) ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Dotyczy pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści formie oświadczenia dotyczący przygotowywania i podawania leków cytostatycznych dla pozycji 7 i 9,10,11,12

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 3

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 3, pozycji 1-4 dopuści: kaniule dożylną bezpieczną z portem bocznym, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, cienkościenny cewnik posiadający trzy paski kontrastujące w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, rozmiary:

1. 24G - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min

2. 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

3. 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min

4. 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 15

Pytanie 12

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 7, pozycji 1 dopuści: wszczepialny port tytanowy o wysokości 10mm i wadze 8 g, z cewnikiem silikonowym o długości 750mm, i śr. wewnętrznej 1.0mm i zewnętrznej 2.2mm, wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kątem 90 stopni 22G, 25mm), tunelizator (szydło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu, rozmiar 6.6F ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 7 pozycji 2 dopuści: wszczepialny port tytanowy o wysokości 10mm i wadze 8 g, z cewnikiem silikonowym o długości 750mm, i śr. wewnętrznej 1.6mm i zewnętrznej 2.8mm, wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kątem 90 stopni 22G, 25mm), tunelizator (szydło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu, rozmiar 8.4F ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści: Igły do portów naczyniowych z zabezpieczeniem przed zakłuciem, jak również przed kontaktem z krwią pacjenta, wyposażone w miękką podkładkę zabezpieczającą skórę pacjenta oraz dren o długości 18cm z zaciskiem do przerw w infuzji, wygodne neodpinane skrzydełka, bez portu bocznego, przystosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem, z oznaczeniem kolorystycznym w zależności od rozmiaru, dostępne w następujących rozmiarach:

20 G x 19 mm; 20 G x 25 mm; 20 G x 38 mm;

19 G x 19 mm; 19 G x 25 mm; 19 G x 38 mm;

22 G x 19 mm; 22 G x 25 mm; 22 G x 38 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy: WSz – II.4.291.23.2017, Pakiet 5 Cewniki, zgłębniki, dreny, ilość pozycji 86, pozycja 71

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 24cm (tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), 28cm (tip to cuff 23cm- nr kat. 32101528),, 32cm (tip to cuff 27cm - nr kat. 32101532),, 36cm (tip to cuff 31cm - nr kat. 32101536),, 40cm (tip to cuff 35cm- nr kat. 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

(pakiet 47) Czy Zamawiający dopuści custompack zawierający w swoim składzie fartuch w rozmiarze 1 – 2 szt?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający, za spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej, uzna dostarczenie wykazu co najmniej 1 wykonanej lub wykonywanej dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w zabiegach okulistycznych dla Pakietu nr 53 poz. 1,3,4 oraz Pakietu nr 57 poz. 4?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź: Nie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dotychczasowa praktyka pokazuje, że w większości umów o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku występuje realizacja na poziomie 60% i powyżej.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia następujących zapisów Wzoru Umowy (§ 6 ust. 2) „...w przypadku podwyżki stawki VAT, zmianie ulegnie tylko cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)”?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30 z dnia 12.04.2017 r. - oznaczenie sprawy – Wsz – II.4.291.23.110.2017

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8, ust. 1, 2,3,4,5 Wzoru Umowy:

- 1) Z 0,3% na 0,1%
- 2) Z 0,3% na 0,1%
- 3) Z 5% na 1%
- 4) Z 5% na 1%
- 5) Z 5% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w Pakiecie nr 57 pozycji nr 4 zaoferować dotorebkowy pierścień napinający wykonany z PMMA, fabrycznie załadowany do jednorazowego implantatora wyłącznie o średnicy 11mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 58 zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 soczewka afakijna, bądź umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje w tym zakresie?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ w części B pkt III.

Pytanie 28**Pakiet nr 10, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści żel do EEG o pojemności 250 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29**Pakiet nr 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści pastę EVERY o pojemności 160g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30**Pakiet nr 10, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści papier o szerokości 109 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31**Pakiet nr 10, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 130x135x370?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32**Pakiet nr 10, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści papier w bloczku 150 składek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33**Pakiet nr 10, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści papier w bloczku 150 składek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Pakiet nr 10, pozycja 28,33,35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet nr 10, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści papier termiczny w rozmiarze 57mmx30m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pakiet nr 21, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

dot. opisu w Formularzu oferty, pkt. 7:

Co Zamawiający ma na myśli w opisie „zgodnie z zapisem powyżej” w przypadku Pakietów oferowanych na pozycje? Czy nie chodzi tu raczej o „zgodnie z poniższym”?

Zapis dla Wykonawcy nie jest zrozumiały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca może składać ofertę na poszczególne pozycje w Pakiecie 49 – 54, Pakiecie 56 – 58, Pakiecie 60, a opis „zgodnie z zapisem powyżej” odnosi się do sposobu wypełniania pkt 7, tj: należy wpisać cenę w zależności od oferowanego Pakietu i pozycji w tym Pakiecie i oddzielnie dla każdego oferowanego Pakietu i pozycji w tym Pakiecie.

Pytanie 38

dot. zapisów § 3 ust. 12 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 45 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 39

dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 3 ust. 3 – 6 wzoru umowy w brzmieniu:

„3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu o maksymalnie 20% i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnego asortymentu wynika z działalności Zamawiającego, tj.:

1) Dostawa towaru będzie realizowana zgodnie z zamówieniem Zamawiającego wynikającym z potrzeby zastosowania określonego asortymentu;

2) Powyższy tryb realizacji może spowodować zmniejszenie zamówień na dany asortyment będący przedmiotem niniejszej umowy maksymalnie o 20% jego wartości;

3) W przypadku zaprzestania stosowania poszczególnego asortymentu w jednostkach organizacyjnych Szpitala, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia wycofanych towarów objętych umową w części nieprzekraczającej 20% ich wartości.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnego asortymentu w ilościach wg zapotrzebowania, w cenach wskazanych w formularzu cenowym, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć wartości umowy określonej w ust. 1, ani nie może być mniejsza niż 80% tej wartości.

5. W przypadku zmniejszenia zamówionych ilości w zakresie wskazanym powyżej niż wskazane w formularzu cenowym, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu, a Wykonawca może żądać należnego wynagrodzenia tylko z tytułu części wykonanej umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

6. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie więcej niż o 20% wartości określonej w ust. 1, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.”

Uzasadnienie: Zamawiający musi wskazać pewną ilość zamówienia, która zrealizowana zostanie na pewno. W przeciwnym razie wykonawca nie ma w ogóle rozeznania co do opłacalności przedsięwzięcia, a tym bardziej nie jest w stanie przedłożyć oferty. Zagwarantowanie wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie co najmniej 80% jest konieczne celem racjonalnego oszacowania ceny ofertowej oraz kalkulacji ryzyka wynikającego z niezrealizowania całego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 40

dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć § 4 ust. 9 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Zobowiązanie wykonawcy nie może wykraczać to, co stanowiło przedmiot jego oferty. Wykonawca zaoferował cenę za konkretne produkty i nie może być zmuszony do dostarczenia po tej cenie innych produktów zwłaszcza w sytuacji opisanej w § 4 ust. 9 wzoru umowy. Zgodnie bowiem z prawem niemożliwość spełnienia świadczenia, wynikająca z przyczyn niezależnych od wykonawcy, powoduje wygaśnięcie zobowiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 41

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się o przyjęcie § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy w brzmieniu:

„2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena **brutto**, cena **netto** pozostanie niezmienna.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30 z dnia 12.04.2017 r. - oznaczenie sprawy – Wsz – II.4.291.23.110.2017

3. Zmiany cen, o których mowa wyżej, **nastąpią automatycznie** od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa **bez potrzeby zmiany umowy.**”

Uzasadnienie: Oferta wykonawcy bazuje na cenie netto. Stawka VAT jest jedynie podatkiem, którego wykonawca jest płatnikiem i na którego wysokość nie ma wpływu. Również zgodnie z PZP (art. 32) wartość zamówienia wyraża się w cenie netto. Zmiana stawki VAT nie powinna zatem prowadzić do zmiany ceny netto, oznaczałoby to bowiem dla wykonawcy realizację zamówienia na warunkach gorszych niż zaoferowane. Jednocześnie nie ma potrzeby, aby waloryzacja ceny brutto wynikająca ze zmiany obowiązującej stawki VAT wymagała aneksu do umowy. Zakres i chwila tej waloryzacji nie budzą jakichkolwiek wątpliwości i mogą w związku z tym następować automatycznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 42

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się o przyjęcie § 7 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu:

„Reklamacja powinna być załatwiona w terminie 5 dni od daty **dostarczenia** Wykonawcy, na jego koszt, zareklamowanego towaru.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 43

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się o przyjęcie § 7 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu:

„Reklamacje mogą być składane faksem i niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Zamawiający uzna, że reklamacje składane za pomocą faksu dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem transmisji). Wszelkie terminy dotyczące reklamacji liczy się od dnia **dostarczenia** Wykonawcy reklamowanego towaru.”

Uzasadnienie: Wykonawca nie może zobowiązać się do wymiany reklamowanego towaru na podstawie samej informacji otrzymanej faksem. W pierwszej kolejności wykonawca musi mieć możliwość naocześnie zbadać zareklamowany towar i dopiero wówczas może ustosunkować się do żądania jego wymiany. Zamawiający powinien zatem dostarczyć wykonawcy towar, którego wymiany się domaga.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 44

dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 7 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku **zwłoki** w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad, która przekroczy 10 dni, Zamawiający może zakupić dany towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę”.

Uzasadnienie: Mianem „opóźnienia” prawo określa każdy przypadek nieterminowego spełnienia świadczenia bez względu na przyczyny. Opóźnienie może zatem nastąpić również z winy zamawiającego albo z powodu siły

wyższej. Przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, określa się natomiast w prawie mianem „zwłoki”. Zasadnym jest, aby wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 45

dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć § 8 ust. 1 – 5 wzoru umowy w brzmieniu:

„1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 3a ust. 3 i § 4 ust. 2 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości **netto niezrealizowanej** dostawy, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki, lecz nie więcej niż 5% tej wartości.**

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 7 ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wartości **netto** towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień **zwłoki, lecz nie więcej niż 5% tej wartości.**

3. W przypadku **nieuzasadnionego** odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości **netto niezrealizowanej** części przedmiotu umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości **netto niezrealizowanej** części przedmiotu umowy.

5. W przypadku określonym w ust.1 i 2, gdy **zwłoka** przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia **netto niezrealizowanej** części przedmiotu umowy.”

Uzasadnienie:

- W przedmiocie naliczania kary umownej od wartości netto a nie brutto proszę o wzięcie pod uwagę argumentów przedstawionych przy zapytaniu o możliwość zmiany § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy;

- W przedmiocie zastąpienia sformułowania „opóźnienie” mianem „zwłoka” proszę o wzięcie pod uwagę argumentów przedstawionych przy zapytaniu o możliwość zmiany § 7 ust. 7 wzoru umowy;

- Brak górnego limitu naliczania kary umownej może spowodować, że urośnie ona do rozmiarów rażąco nieproporcjonalnych w stosunku do poniesionej przez zamawiającego szkody, a w takim wypadku nie będzie już spełniać roli odszkodowawczej, ale służyć będzie wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy. Celem uniknięcia takiej możliwości zasadne jest wprowadzenie limitu naliczania kary umownej na poziomie 5%, skoro takiej wysokości karę zobowiązany będzie zapłacić wykonawca w sytuacji niewykonania umowy w ogóle. W razie uzasadnionej potrzeby zamawiający i tak będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego;

- Żądanie kary umownej w każdym przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę jest nieuzasadnione w świetle zasad współżycia społecznego. Jeżeli wykonawca będzie miał powód do odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, to czemu miałby jeszcze płacić z tego tytułu karę na rzecz zamawiającego. Konieczne jest zatem doprecyzowanie, iż chodzi wyłącznie o nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 46

dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć § 4 ust. 2 „Zasad udostępniania instrumentarium” w brzmieniu:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z wadami udostępnionego instrumentarium, jak również za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, chyba że wady lub niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy wynikają z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”

Uzasadnienie: Sam fakt, że rzecz obarczona jest wadą albo że umowa nie została wykonana, nie przesądza jeszcze o tym, z jakiej przyczyny rzecz jest wadliwa albo dlaczego nie wykonano umowy. Rzecz może być wadliwa na skutek uszkodzenia jej przez zamawiającego, zaś umowa może zostać niewykonana na przykład na skutek działania siły wyższej. Są to przykładowe okoliczności, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w związku z czym nie powinien ponosić również odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Czy w Pakiecie nr 54 poz. 3 Zamawiający dopuści manipulator Sinskey z końcówką 0,15mm i tytanową rękojeścią?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 48

Czy w Pakiecie nr 57 poz. 6 Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. pierścień do mechanicznego rozszerzania żrenicy wszczepiany injektorem jednorazowym. Wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia. W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 49

Czy w Pakiecie nr 57 poz.4 Zamawiający dopuści pierścienie dotorebkowe w w rozmiarach:11-14mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Czy w Pakiecie nr 59 Zamawiający dopuści noże crescent o szerokościach: 1.25mm, 2.0mm i 2.3mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 51

Dot. Projekt umowy §6 ust.2

Proszę o zmianę brzmienia §6 ust 2 projektu umowy na następujące:

"Ceny netto przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy.. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. Zmiana stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy"

Podniesienie stawki VAT o 15% bez zmiany jednostkowej ceny brutto jak wypadku wspomnianego punktu wzoru umowy jest dla dostawców wyrobów medycznych niemożliwe do zaakceptowania przy obecnym modelu wyceny przy przetargach , jako iż podniesienie stawki VAT przekroczyłyby z pewnością średnią marżę, która rzadko kiedy przekracza poziom 15 % Co z kolei wymusza albo konieczność dostarczania przedmiotu umowy ze stratą dla dostawcy lub uprzedniego wkalkulowania ewentualnej podwyżki VAT w cenę oferowanych produktów. Takie rozwiązania są niekorzystne dla zamawiającego ponieważ albo spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia w tym też zyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej albo też zawęzi krąg potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30 z dnia 12.04.2017 r. - oznaczenie sprawy – Wsz – II.4.291.23.110.2017

Pytanie 52

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzycielności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30 z dnia 12.04.2017 r. - oznaczenie sprawy – Wsz – II.4.291.23.110.2017

Pytanie 56

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca na własny koszt odbierze zareklamowany towar i dostarczy nowy bez wad.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 57

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad, która przekroczy 10 dni, Zamawiający może zakupić dany towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,3% na 0,1% oraz odpowiednio z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 59

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy opóźnienie przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 60

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsów hemostatycznych o szerokości rozwarcia ramion 12 mm oraz o długości narzędzia 230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego postępowania punktu

nr 4. Uszczelki do trokaru średnica Ø 11 mm op. a 10 szt.***, oraz punktu

nr 5. Uszczelki do trokaru średnica Ø 5,5 mm op. a 10 szt. ***?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 41 – Igły doszpikowe

Pytanie 62

W związku z tym, że na polski rynek trafiają aparaty do wkłucia doszpikowego pochodzące z prywatnego, nieautoryzowanego przez producenta, kanału dystrybucji pragniemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone wkłucie doszpikowe posiadało, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta, etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski - odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 63

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych lub czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu przedłożył pisemne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora igieł doszpikowych na terenie polski o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie 64

W związku z tym, iż na rynku oferowane są różne igły doszpikowe, różnego pochodzenia i z różnym terminem ważności, czy Zamawiający wymaga, aby oferowane igły posiadały 5- letni okres ważności, a w dniu dostawy był zachowany okres min. 80% całkowitego terminu ważności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 65

Dotyczy wzoru umowy § 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie kar umownych w § 8 ust. 1 i 2 do 1%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarze całkowitym 915x430x880mm (wymiar bez koszyka drucianego i miski)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 05.05.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2017 r. o godz. 10:15.


DYREKTOR
Wiktor Stasiak