

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Pakietu 1**Pytanie 1**

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykończony elastycznymi bawełnianymi mankietami o długości 6cm? ; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Poz. 5,6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wyposażony w troki dł. 40cm każdy? ; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, w którym przednia część wzmocnienia wykonana jest z niebieskiej nieprzepuszczalnej mikroporowatej folii PE o grubości 35 μ , pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu 2**Pytanie 4**

Poz. 7- Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne prześcieradło wzmocnione niebieskimi włóknami co ok 30mm?; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 53x118, wyposażone w taśmy lepne o wymiarach 5x110cm; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Poz. 13- Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na zwłoki, wykonany z zielonej włókniny o wymiarach 160x220cm bądź pokrowiec wykonany z czarnej folii w rozmiarze 70x220cm wraz z rękawicami? Pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7**Dotyczy projektu umowy**

§ 3 ust. 14 – Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy na taki, który będzie uwzględniał zmianę ceny brutto wynikającą zarówno z ewentualnego wzrostu jak i obniżenia podatku VAT, natomiast cena netto pozostanie na niezmiennym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawk na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje: 1,3,4,5,6,7,8,10,11): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje: 6,7,8): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących

nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje moczu do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje: 6,7,8): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje: 6,7,8): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje: 6,7,8): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 11): piankę myjąco – dezynfekcyjną o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 10): chusteczki nawilżające w opakowaniu 48 sztuk, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 10): podkłady ginekologiczne niejałowe w rozmiarze co najmniej 34 x 12cm i o chłonności co najmniej 580 ml?

Odpowiedź: Pakiet 4, pozycja 10 nie dotyczy podkładów.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 6): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 7): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o obwodzie produktu co najmniej 110 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 8): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o obwodzie produktu co najmniej 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje: 3,4,5): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 12): Podkład celulozowy w rolce, kolor biały o szer. 50 cm dł. 40 m, perforowany. z przeliczeniem ilości na 375 rolek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34**Dotyczy pakietu 1 pozycja 8-10**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 1 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców przystąpić do postępowania, zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35**Dotyczy pakietu 1 pozycja 8**

Proszę o zgodę na zaferowanie sterylne go fartucha zabiegowego wykonanego z włókniny typu SMMMS – tj. włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36**Dotyczy pakietu 8 pozycja 10**

Proszę o zgodę na zaferowanie sterylne go pełnoochronne go fartucha chirurgiczne go posiadające go wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (z białą folią polietylenową) o łączne go gramaturze min. 28g/m² przy jednoczesne go odporności na przenikanie cieczy na poziomie 180 cm H₂O. Niższe go gramatura laminatu daje wyższe go komfort pracy operatora przy równoczesne go zachowanie bezpieczeństwa pracy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37**Dotyczy pakietu 2 pozycja 1-4**


Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 2 i utworzenie z nich osobne go części. Modyfikacja ta pozwoli większe go ilości wykonawców przystąpić do postępowania, zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy pakietu 2 pozycja 1

Proszę o zgodę na zaferowanie sterylnego obłożenia do artroskopii kolana w skład którego wchodzi:

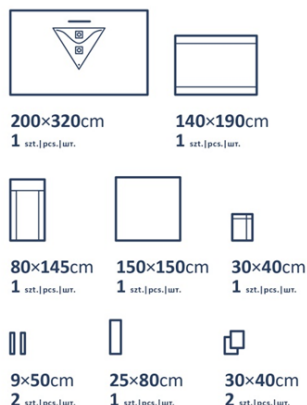

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę $\varnothing 7$ i $\varnothing 5$ cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m².


Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy pakietu 2 pozycja 2

Proszę o zgodę na zaferowanie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych w skład którego wchodzi:

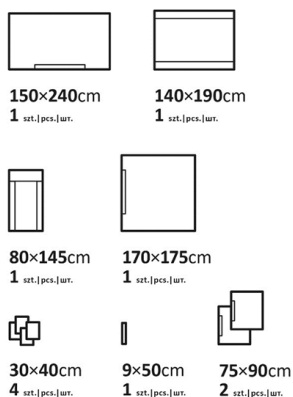

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x175cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
 - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m².


Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Dotyczy pakietu 3 pozycja 3

Proszę o zgodę na zaferowanie zestawu do cesarskiego cięcia w skład którego wchodzi:

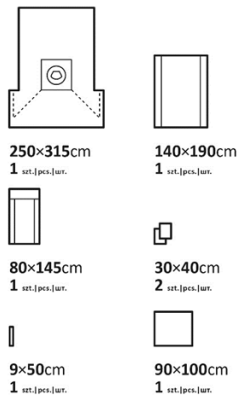


- 1.1 osłona na stolik Mayo 80x145cm,
 - 2.1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu),
 - 3.1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
 - 4.1 serweta do owinięcia noworodka o wym. 90x100cm,
 - 5.1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
 - 6.2 ręczniki celulozowe 30x40cm (chłonne).
- Serwety wykonane z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².
- Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy pakietu 3pozycja 4

Proszę o zgodę na zaferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego w skład którego wchodzi:

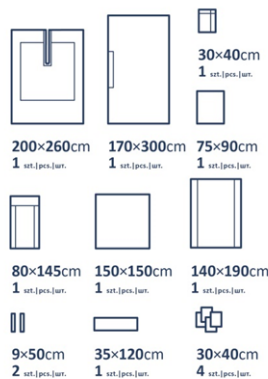

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Obłożenie chirurgiczne wykonane jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m² i spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795. Obłożenie w strefie krytycznej spełnia następujące parametry: odporność na przenikanie cieczy 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa i na mokro 170 kPa. Na opakowaniu jednostkowym każdego produktu jest etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami posiadającymi indeks wyrobu (numer LOT, datę ważności, nazwę dostawcy), które można odkleić i dołączyć do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2017 r. o godz. 10:15.